


RO排水熱回収システム



H X S e r i e s

ヒート・エクスチェンジ (HX) システムは、透析用水作製装置から破棄される、RO排水が持っている熱量を熱交換方式により、透析用水作製装置供給原水の加温熱源として回収し、原水加温の電力を節電します。

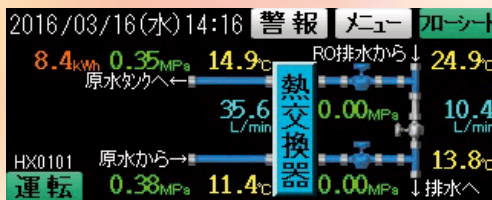

フローシート画面



削減熱量画面




*多人数用透析用水作製装置へのキャビネット内蔵も可能



標準仕様

型式	対象透析用水作製装置	装置接続配管口径		寸法 (W×D×H)	製品重量 (Kg) 運転重量 (Kg)	電源 50Hz/60Hz
		原水 (in・out)	RO排水 (in・out)			
HX-1	8インチ1~2本	25A	20A	420×550×1,025	60/64	単相100V 10A
HX-2	8インチ3~4本	32A	25A		66/71	

年間ヒータ使用電力削減額

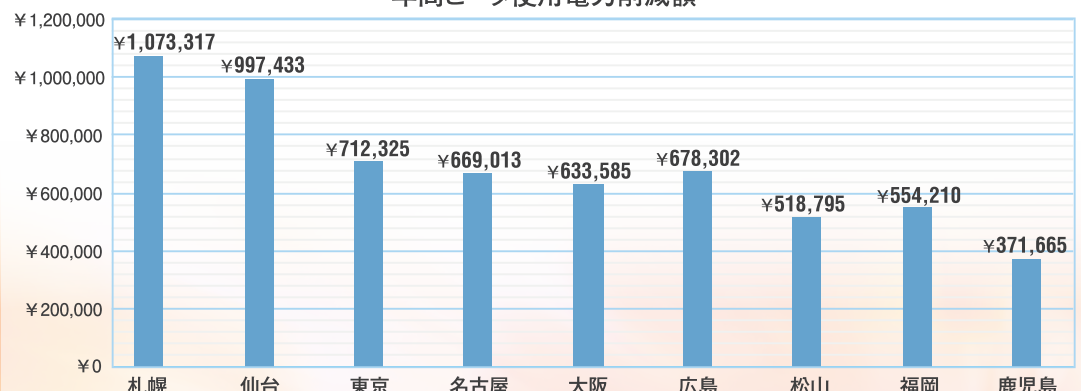

※当社テスト条件による試算のため、実際の削減量、削減額と異なる場合がございます。

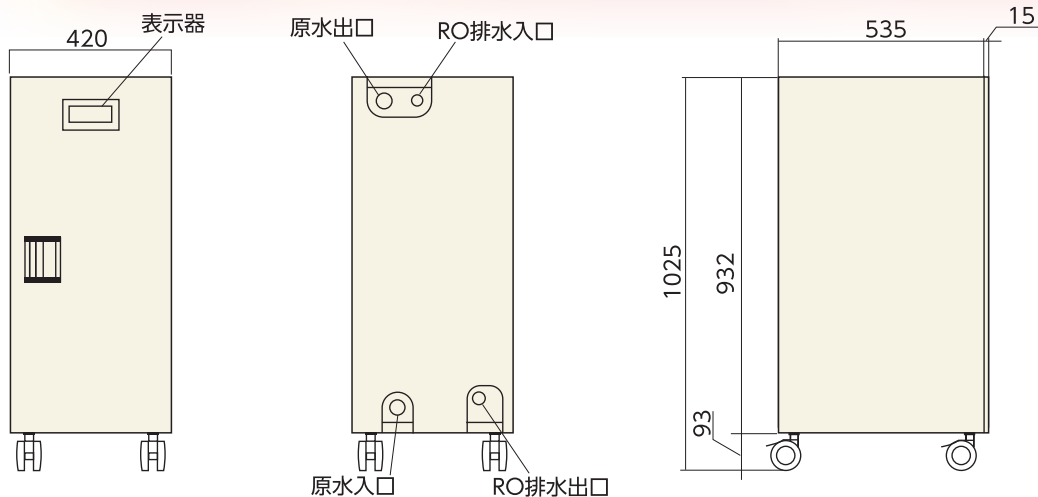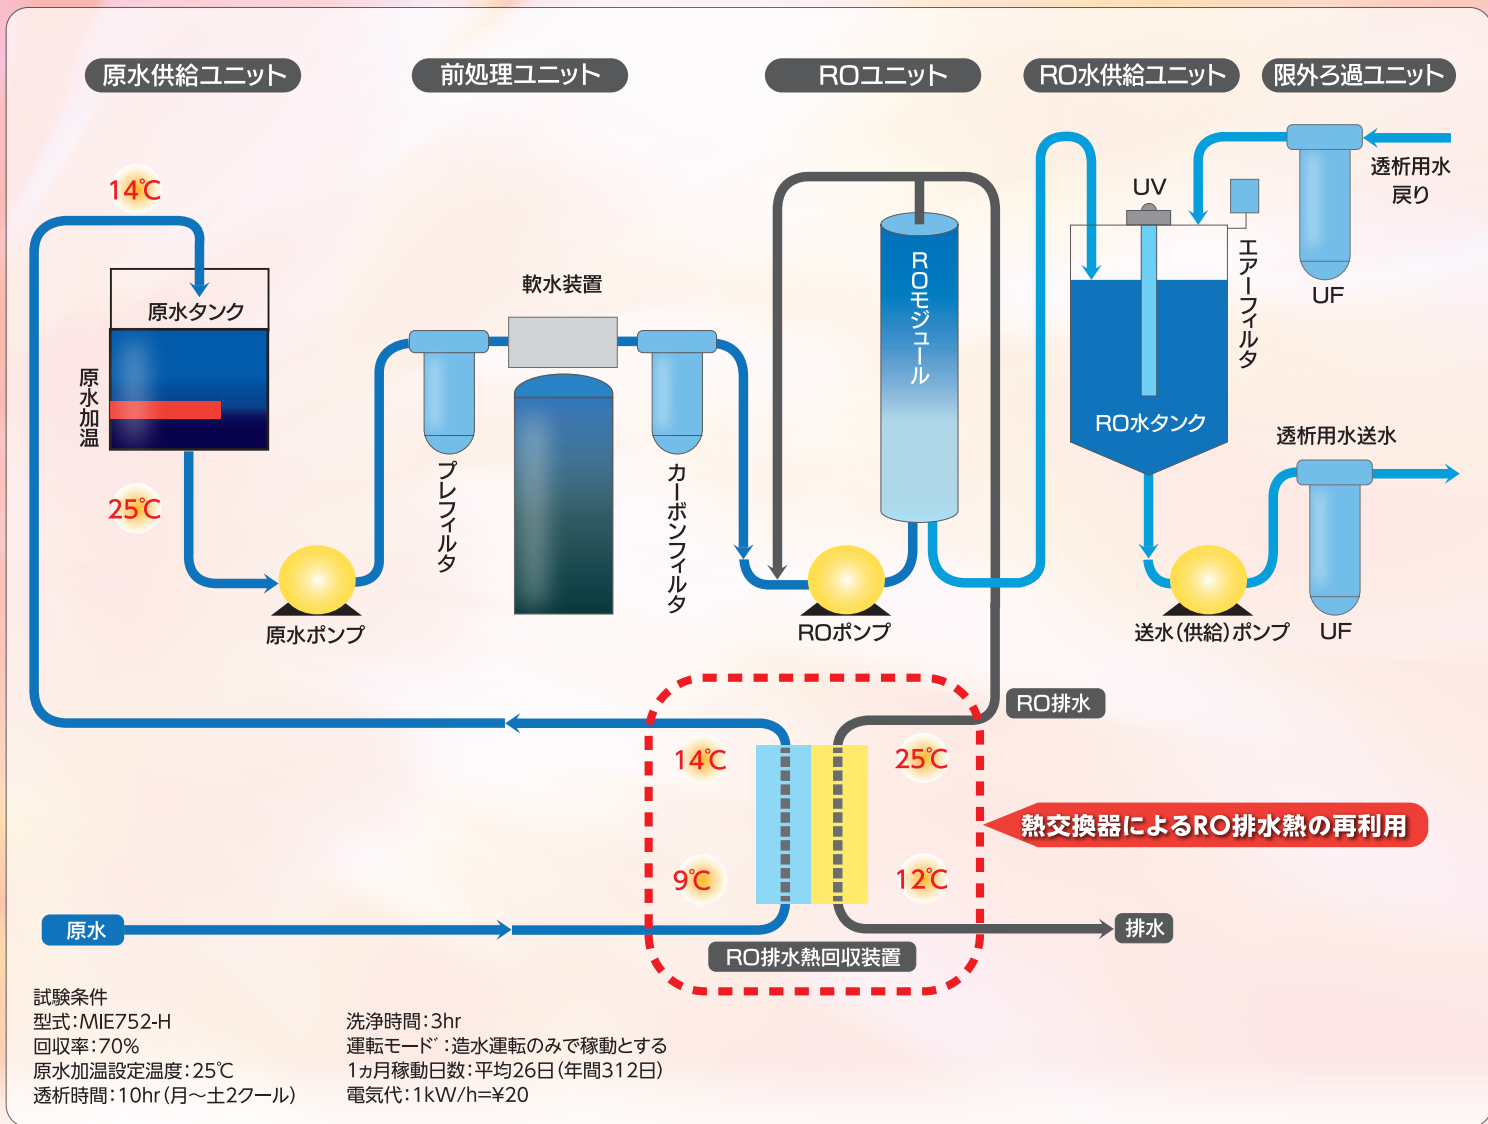

カタログ記載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

カタログ発行:2024.02



日本ウォーターシステム株式会社

<http://www.j-waters.co.jp>

本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-9-4 西野金陵ビル4F
 関東支社 〒104-0042 東京都中央区入船2-3-7 築地エー・アイ・ユービル1F
 東京支店 〒104-0042 東京都中央区入船2-3-7 築地エー・アイ・ユービル1F
 埼玉営業所 〒351-0111 埼玉県和光市下新倉5-9-22
 松本出張所 〒390-0814 長野県松本市本庄1-2-16 YMマンション1F
 大阪支店 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-5-12
 北海道営業所 〒004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央3条5-7-25
 東北営業所 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井6-4-1
 中部営業所 〒463-0072 愛知県名古屋市中区金屋2-191-1
 広島営業所 〒733-0032 広島県広島市西区東観音町25-3
 九州営業所 〒813-0032 福岡県福岡市東区土井2-24-10
 南九州営業所 〒899-5651 鹿児島県姶良市脇元627-3
 JWS 四国 〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル6F
 タングラム 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-5

TEL.03(4321)0150(代表) FAX.03(4321)0149
 TEL.03(3553)2080 FAX.03(3553)2081
 TEL.03(3553)2080 FAX.03(3553)2081
 TEL.048(450)3950 FAX.048(466)4313
 TEL.0263(38)3115 FAX.0263(38)3116
 TEL.06(6387)1104 FAX.06(6387)3241
 TEL.011(796)8255 FAX.011(796)8256
 TEL.022(288)3112 FAX.022(288)3113
 TEL.052(799)5230 FAX.052(799)5231
 TEL.082(233)9351 FAX.082(233)9357
 TEL.092(719)1252 FAX.092(719)1253
 TEL.0995(73)7817 FAX.0995(73)7818
 TEL.087(832)5771 FAX.087(832)5772
 TEL.0548(29)0421 FAX.0548(25)0010

